


No coma, beba, fume, se cepille los dientes ni mastique chicle durante 30 minutos antes de su uso.
Verifique que el nivel de líquido esté en la línea de 4 ml antes de abrir.

1




1. Retire la tapa del tubo.
Guarde la tapa para uso posterior.
Enrosque el embudo de recogida en el tubo.

2

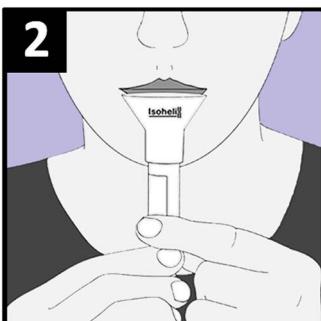


2. Escupir en el embudo hasta que el nivel del líquido en el tubo, excluyendo burbujas, alcance la línea de 4 ml.
El depósito de saliva puede tardar entre 2 y 5 minutos.

3

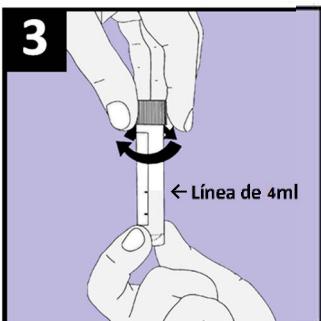

3. Desenrosque el embudo de recolección y vuelva a colocar la tapa del tubo.
Desechar el embudo.

4

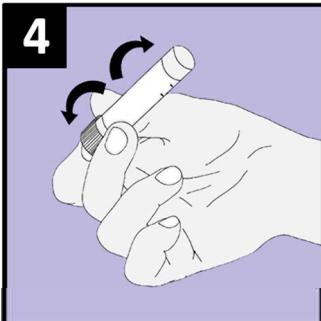

4. Agite el tubo colector varias veces para mezclar la saliva con la solución.

MANTENER A TEMPERATURA AMBIENTE DESPUES DE LA TOMA DE MUESTRA

Precauciones: no ingerir. Si la solución estabilizadora entra en contacto con la piel o los ojos, lávese abundantemente con agua. La tapa del tubo puede representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.

